



计量器具型式评价报告

(测量用电流互感器 15280500)

报告编号 DCX-20220800011



浙江省计量科学研究院

一、注意事项

- 1、本报告涂改、无型式评价实验室专用章、无型式评价人员、复核员、批准人签字无效。
- 2、复制本报告未重新加盖型式评价实验室专用章无效。
- 3、本报告由正文和附件 1、附件 2 组成，不得单独使用。
- 4、本报告依据的国家技术规范有变动或申请单位对批准的型式做出改动时，申请单位应及时申请重新进行型式评价。
- 5、申请单位对本报告有异议时，应在接到本报告 15 日内向承担型式评价的技术机构或受理申请的政府计量行政部门提出书面复议申请。否则视为接受本报告的结论。

二、说明

- 1、报告一律用 A4 纸打印。
- 2、本报告一式三份（技术机构、申请单位各一份，委托单位一份）。



微信公众号

地址：浙江省杭州市江干区下沙路 300 号 咨询电话：0571-85027145

网址：www.zjim.cn

投诉电话：0571-85025361

一、申请和委托的基本情况

(一) 制造单位: 浙江金准仪表有限公司

申请单位: 浙江金准仪表有限公司

代理人: 胡加一琦

(二) 委托单位: 乐清市市场监督管理局

委托日期: 2021 年 08 月 11 日

委托负责人: 万蓉蓉

(三) 申请书编号: C82202100188 新型

二、关于型式的基本信息:

(一) 计量器具名称及分类编码

测量用电流互感器 15280500

(二) 工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号

测量用电流互感器根据其工作原理可分为电磁式电流互感器(以下简称电流互感器)和电子式电流互感器,样机为电流互感器。

电流互感器采用电磁感应原理,将大电流按比例要求转换成小电流,用于电流监测和电能计量。

样机为户内设备

工作环境温度范围为: $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

海拔高度: 1000m 及以下。

生产所依据的标准和编号:

GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分: 通用技术要求

GB/T 20840.2-2014 互感器 第 2 部分: 电流互感器的补充技术要求

(三) 样机型号、规格、准确度级别/最大允许误差/不确定度及编号

型号	规格	准确度级别	编号
LMZJ1-0.66	150A/5A 600A/5A 2000A/5A	0.2S 级	20210807 20210808 20210809

(四) 计量器具的测量参数

序号	测量参数名称	测量参数单位	测量区间	计量性能指标
1	比值差 相位差	% [角] 分 (')	(0.01-1.2) I_{pr}	0.2S 级

(五) 试验环境条件

温 度: (20~23)℃

相对湿度: (60~65)%

(六) 工厂明示的关键零部件和材料表

序号	关键件名称	型号	规格	性能指标说明	制造厂 (生产厂)
1	铁芯	超微晶 1K107	0.2S级用	磁感应强度: 1.2T	乐清市瑞能磁晶有限公司 乐清市金立磁晶有限公司 安徽先锐软磁科技有限公司 浙江治泰软磁科技有限公司
2	铁芯	硅钢片 Z11 0.2385	0.5、0.2、0.5S 级用	磁感应强度: 1.8T	佛山市中磁铁芯制造有限公司 昆山奕和电子有限公司 无锡南飞电子有限公司 乐清市精密铁芯制造厂 乐清市嘉英凯电器有限公司
3	绕组导线	QZ-2/130	$\Phi=0.83\text{mm}$ $\Phi=0.9\text{mm}$ $\Phi=0.6\text{mm}$	电阻率: $0.01286\ \Omega\text{mm}^2/\text{m}$ 电阻率: $0.01395\ \Omega\text{mm}^2/\text{m}$ 电阻率: $0.00627\ \Omega\text{mm}^2/\text{m}$	浙江亿正电工科技有限公司 红旗集团江西铜业有限公司 红旗电缆电器仪表集团有限公司 江山恒昌电线有限公司 宁波金田新材料有限公司
4	绝缘浇注体	树脂	E 系列 192、196	符合 GB/T1732、GB/T2571 要求	上海巴瑞材料科技有限公司 太仓市联安新型绝缘材料制造厂 江西腾德实业有限公司 宁波市裕圣环保材料有限公司 温州市宏得利树脂有限公司

三、型式评价的依据

JF 1701.4-2019 《测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器》

四、型式评价所用仪器设备一览表

序号	仪器设备名称	编号	证书有效期
1	带升流器电流互感器	014491-4 A	2024-7-7
2	全功能互感器校验仪	167676D-8	2022-8-5
3	耐压试验器	970896C	2023-3-1
4	电流互感器开路电压测试仪	024919B	2022-8-26
5	数字直流电桥	055332B	2023-7-21
6	电流互感器温升试验装置	178138C	2023-3-20
7	数据采集系统	8711CA15A	2022-11-22

五、型式评价项目及评价结果一览表

序号	型式评价项目	评价结果（3台）						备注
		20210807		20210808		20210809		
		+	-	+	-	+	-	
1	计量单位审查	×		×		×		观察项目
2	外部结构审查	×		×		×		观察项目
3	标志审查	×		×		×		观察项目
4	准确度级别审查	×		×		×		观察项目
5	绕组极性检验	×		×		×		/
6	标志的检验	×		×		×		/
7	二次端工频耐压试验	×		×		×		/
8	匝间过电压试验	×		×		×		/
9	准确度试验	×		×		×		/
10	温升试验	/		×		×		/
11	短时电流试验	/		×		/		/

注:

+	-
×	
	×

通过
不通过

六、审查的技术资料及结论

经审查,申请单位提交的技术资料符合《JJF 1701.4-2019 测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器》的要求。

七、型式评价结论及建议:

试验样机符合《JJF 1701.4-2019 测量用互感器型式评价大纲 第4部分:电流互感器》的要求,建议批准下列型号计量器具的型式:

型号 LMZJ1-0.66 系列产品

规格 设备最高电压: 0.66kV

额定一次电流: (150~2000) A

额定二次电流: 5A

二次绕组数量: 1

准确度级别: 0.2S级/0.2级/0.5S级/0.5级

八、其他说明:

附件1 型式评价记录表

附件2 样机的照片组图(正视,侧视,铭牌及产品总装图)

附件3 样机的封存

九、签发

1. 型式评价时间: 从 2022 年 04 月 22 日到 2022 年 07 月 11 日
2. 型式评价人员: 周松军 孙平 (签字)
3. 复核员: 倪巍 (签字)
4. 技术负责人: 邵 (签字) 职务: 所长
5. 签发日期: 2022 年 08 月 05 日
6. 承担型式评价的技术机构: 浙江省计量科学研究院 (盖型式评价专用章)

型式评价专用章

附件 1: 型式评价记录表

序号	试验项目名称	试验项目合格判定要求	试验数据记录 (3 台)			结论
			20210807	20210808	20210809	
1	计量单位审查	电流互感器的电流计量单位为 A(安)或者 kA (千安)。	符合	符合	符合	合格
2	外部结构审查	对于影响电流互感器计量性能及绝缘性能的关键部位,应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位置。 对需要进行现场检测的电流互感器,应有方便现场检测的接口、接线端子等结构。	符合	符合	符合	合格
3	标志审查	应在电流互感器的铭牌或面板等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识,其标志和标识应清晰可辨、牢固可靠。	符合	符合	符合	合格
4	准确度级别审查	电流互感器的准确度级别应从以下序列中选取: 0.1 级、0.2S 级、0.2 级、0.5S 级、0.5 级、1.0 级。主要参数为额定一次电流、额定二次电流、准确度级别、功率因数、额定负荷和下限负荷。 额定一次电流标准值为: 10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A 及其十进制倍数或小数。	符合	符合	符合	合格
5	绕组极性检验	标有 P1、C1 (如果有) 和 S1 的所有端子在同一瞬间应具有同一极性。	符合	符合	符合	合格
6	标志的检验	铭牌、标志、接地栓、接地符合、出线端子应符合要求。	符合	符合	符合	合格
7	二次端工频耐压试验	短接的各二次绕组对二次绕组及地之间应耐受工频电压 3kV, 60s, 应无闪络或击穿。	3kV/50Hz/60s 无闪络 未击穿	3kV/50Hz/60s 无闪络 未击穿	3kV/50Hz/60s 无闪络 未击穿	合格

序号	试验项目名称	试验项目合格判定要求	试验数据记录（3 台）			结论
			20210807	20210808	20210809	
8	匝间过电压试验	二次绕组开路,对一次绕组施加额定一次电流（或额定扩大一次电流）持续 60s。在达到额定一次电流（或额定扩大一次电流）之前，如果试验电压峰值达到 4.5 kV，则应限制施加电流。	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	合格
9	准确度试验	在额定功率因数及额定负荷范围内，二次绕组准确度级别应满足 0.2S 级要求	见附表 1	见附表 1	见附表 1	合格
10	温升试验	电流互感器的一次电流等于额定连续热电流,且带功率因数为 0.8 的额定负荷,互感器的温度达到稳定状态。 绕组温升≤60K。	/	13K	29K	合格
		电流互感器的一次电流等于额定连续热电流,且带功率因数为 0.8 的额定负荷,互感器的温度达到稳定状态。 绕组出头温升≤50K。	/	绕组出头： 5K	绕组出头： 12K	
11	短时电流试验	短时热电流：30kA(有效值) 持续时间：1s 短时热稳定值：900（kA） ^{2s} 动稳定电流 75kA(峰值) 复试 7~9 各项，应符合相应技术要求。	20210808			合格
			示波图见附表 2 复试 7~9 各项，符合要求			

具型

1
价

附表 1:

基本误差


温 度: 20℃, 相对湿度: 62%

样机编号	变比	准确度 级别	$I_x/I_n(\%)$ 误 差	1	5	20	100	120	二次负荷 $\cos \phi = 0.8$
20210807	150A/5A	0.2S 级	电流误差(%)	+0.04	+0.04	+0.06	+0.04	+0.10	2.5VA
			相位误差(′)	+8	+7	+4	+5	+2	
20210808	600A/5A	0.2S 级	电流误差(%)	+0.00	+0.00	+0.02	+0.06	+0.06	5VA
			相位误差(′)	+7	+4	+2	+1	+1	
			电流误差(%)	/	+0.02	+0.04	+0.06	/	2.5VA
			相位误差(′)	/	+4	+2	+1	/	
20210809	2000A/5A	0.2S 级	电流误差(%)	-0.00	-0.02	-0.02	+0.00	+0.00	10VA
			相位误差(′)	+4	+3	+1	+1	+1	
			电流误差(%)	/	0.02	+0.02	+0.00	/	2.5VA
			相位误差(′)	/	+4	+1	+1	/	


式评

用1

附表 2: 短时热电流试验示波图

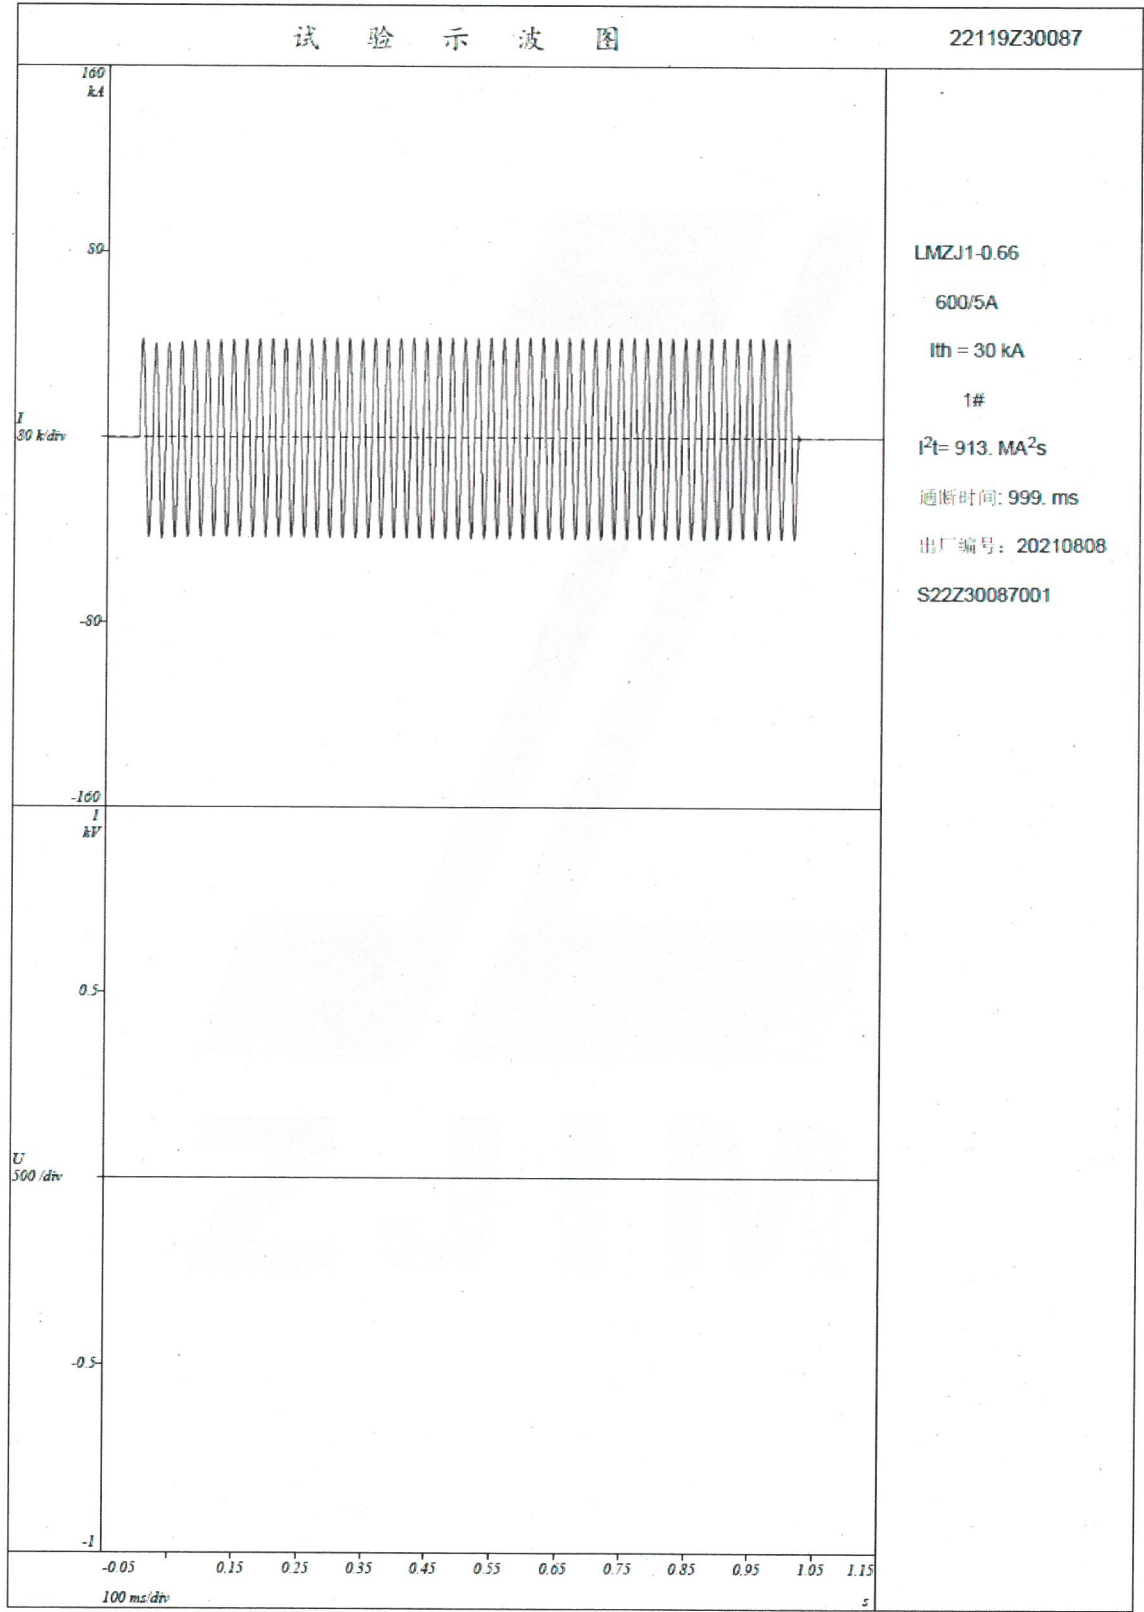


动稳定电流试验示波图

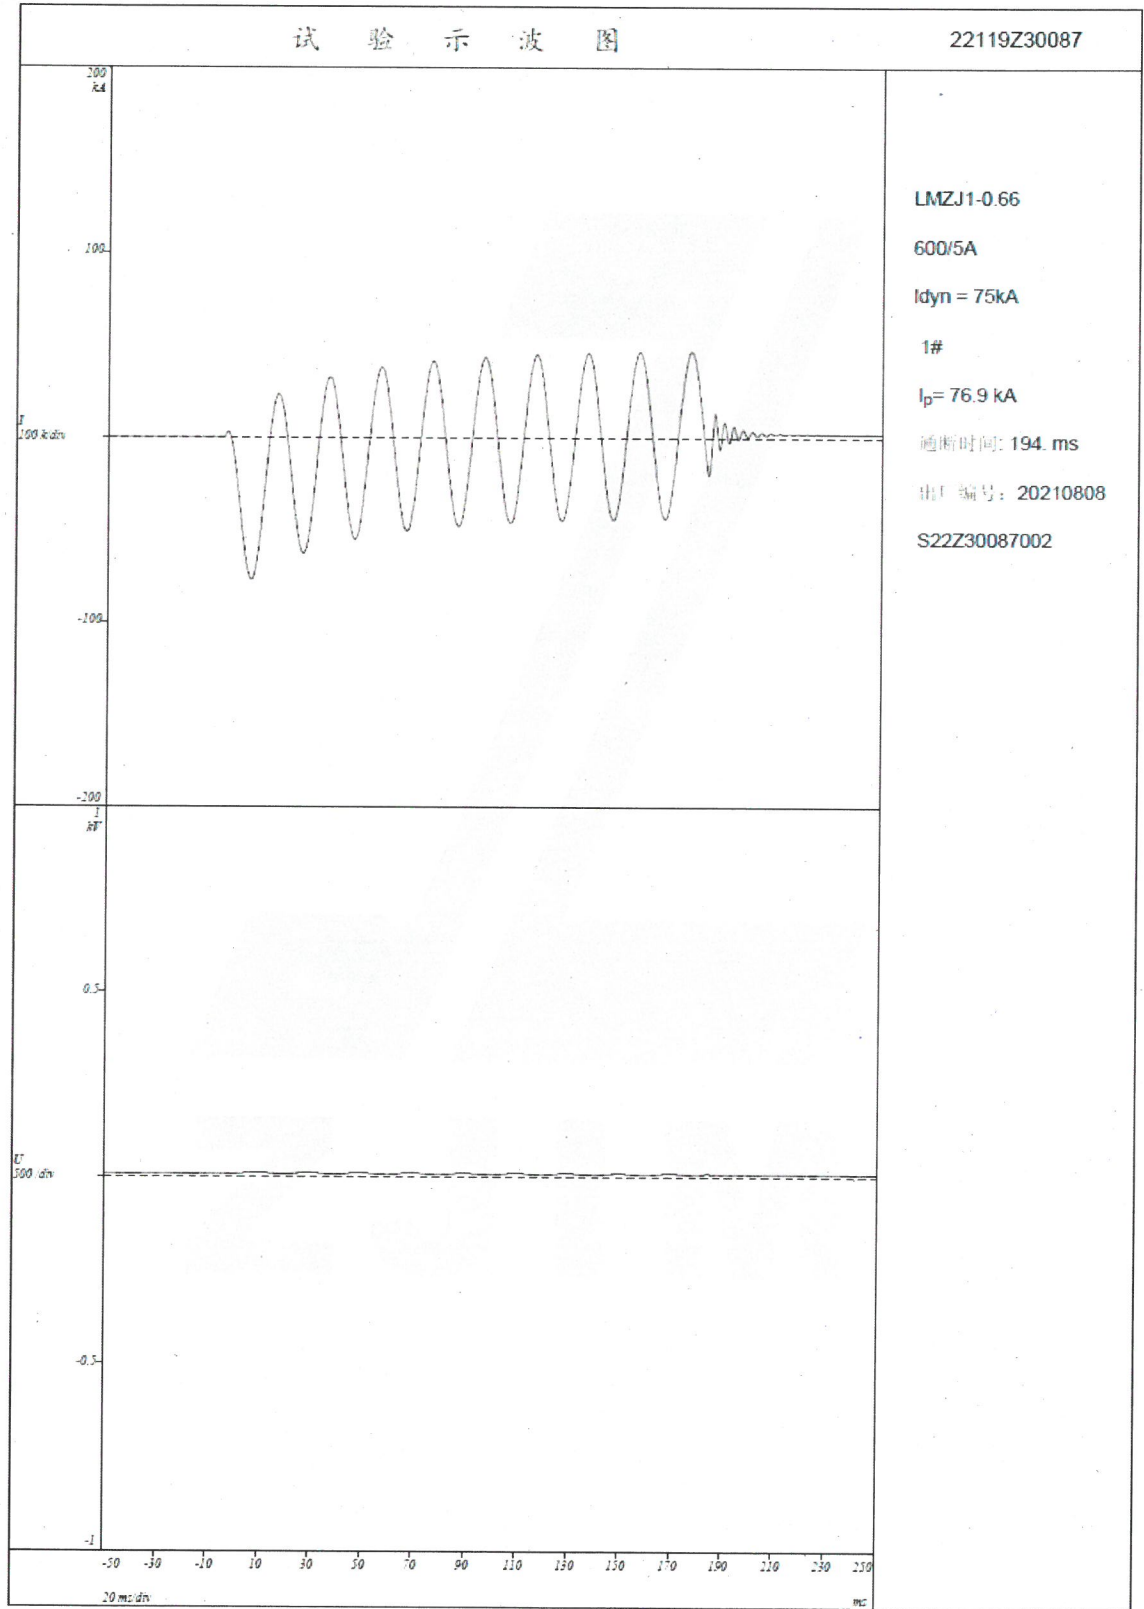

浙江省
新型

附件 2 样机的照片组图（正视，侧视，铭牌及产品总装图）

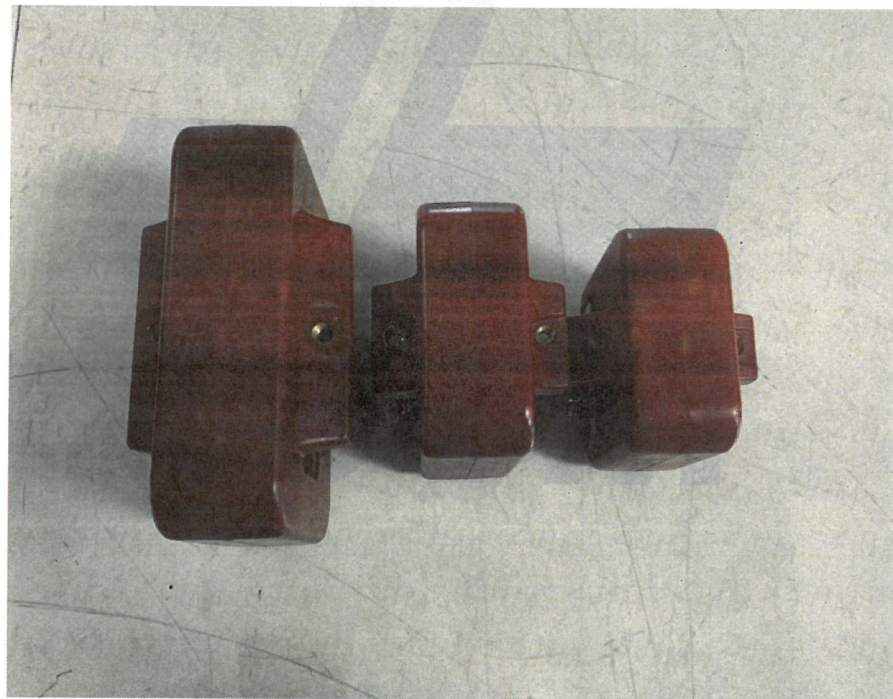

LMZJ1-0.66 电流互感器



电流比: 150/5A	准确度: 0.2S级	标准: GB/T20840.2-2014
额定负荷: 2.5VA	绝缘水平: 0.66/3/-kV	额定短时热电流: 6kA/s
穿心匝数: 1 匝	最高电压: 0.66kV	额定动稳定电流: 15kA
出厂编号: 20210807	出厂日期: 2021年08月	COSΦ=0.8 频率: 50Hz

浙江金准仪表有限公司

LMZJ1-0.66 电流互感器



电流比: 600/5A	准确度: 0.2S级	标准: GB/T20840.2-2014
额定负荷: 5VA	绝缘水平: 0.66/3/-kV	额定短时热电流: 30kA/s
穿心匝数: 1 匝	最高电压: 0.66kV	额定动稳定电流: 75kA
出厂编号: 20210808	出厂日期: 2021年08月	COSΦ=0.8 频率: 50Hz

浙江金准仪表有限公司

LMZJ1-0.66 电流互感器




电流比: 2000/5A	准确度: 0.2S级	标准: GB/T20840.2-2014
额定负荷: 10VA	绝缘水平: 0.66/3/-kV	额定短时热电流: 50kA/s
穿心匝数: 1 匝	最高电压: 0.66kV	额定动稳定电流: 125kA
出厂编号: 20210809	出厂日期: 2021年08月	COSΦ=0.8 频率: 50Hz

浙江金准仪表有限公司

具型

1
价表

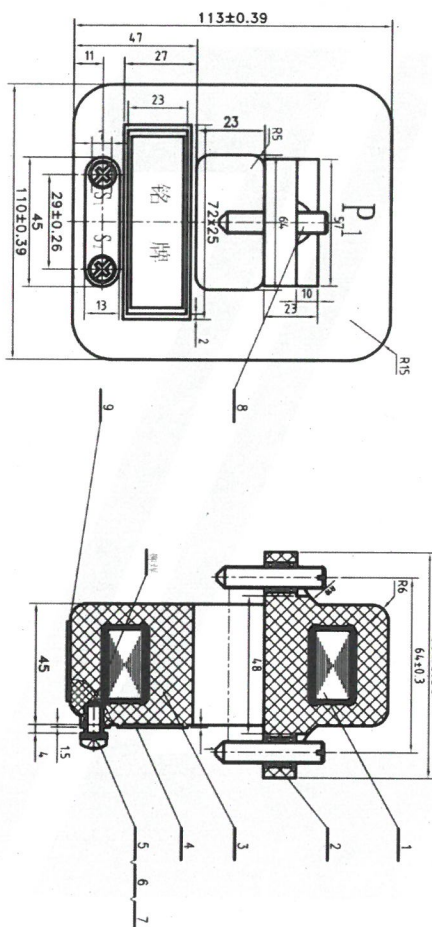


技术要求

1. 壳体表面应平滑、无裂纹、缺口等缺陷;
 2. S1、S2、P1等标记字符为真体凸字, 标记应清晰;
 3. 未注公差尺寸按GB/T1804-m;
 4. 浇注料为粉红色;
 5. 成品按产品标准GB/T20840.2-2014规定进行各项试验;
- 测试合格后在铭牌上打印标记。

[illegible]

附件 3: 样机的封存

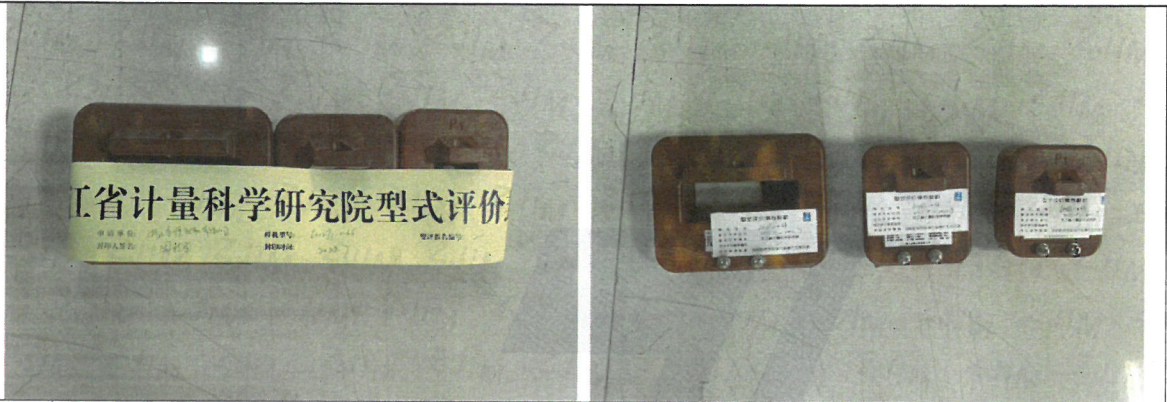	
样机型号:	LMZJ1-0.66
型号评价时间:	2022 年 04 月 22 至 2022 年 07 月 11 日
型号评价单位:	浙江省计量科学研究院
型号评价报告编号:	DCX-20220800011
样机封印及标记:	样机封印条
样机保存数量:	3 台
样机保存时间:	2022 年 07 月 11 日
样机保存地点:	浙江金准仪表有限公司
样机保存期限:	该样机保存至该产品停产五年以后

